











Ciclo de reprocesamiento de instrumentos

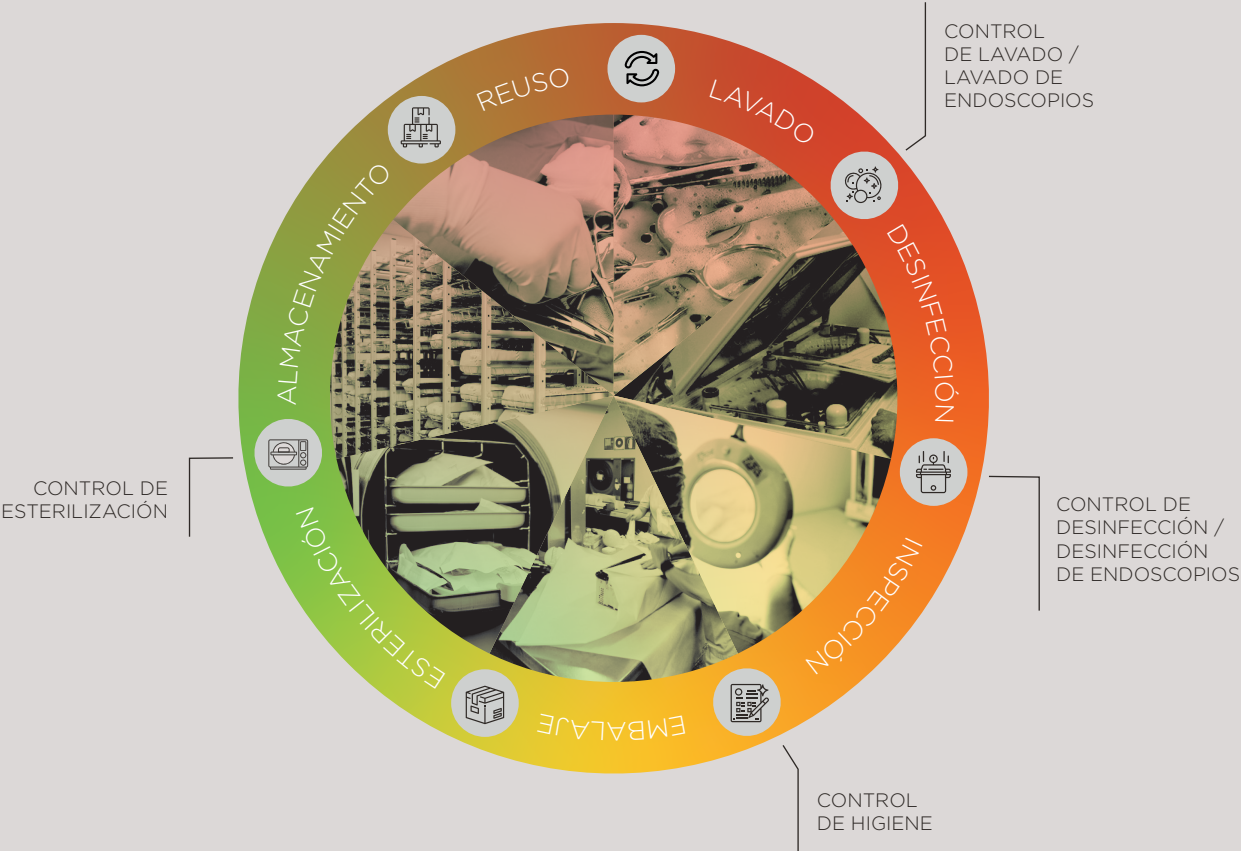

Central de Esterilización



Control de Lavado	Control de Desinfección	Control de Higiene	Control de Esterilización
Chemdye® Splat CDWA4 / CDWA3 / CDWAH Holder	Integron® IT27W-5 / IT27W-10	Chemdye® PRO1 MICRO	Indicadores Biológicos (Liberación de carga)
 Trazanto			
Lavado de Endoscopios	Desinfección de Endoscopios	Higiene de Endoscopios	Indicadores Químicos: Tipo 4, 5, 6 (Control de parámetros)
Chemdye® LUMENIA SIXFLOW	Bionova® KBT400 Integron® IT400 / IT401	Chemdye® KPRO2-E250	
			Indicadores Químicos: Tipo 1 (Control de exposición)
			



Obtenga un control de calidad y trazabilidad completos a través del software Bionova® Cloud.

