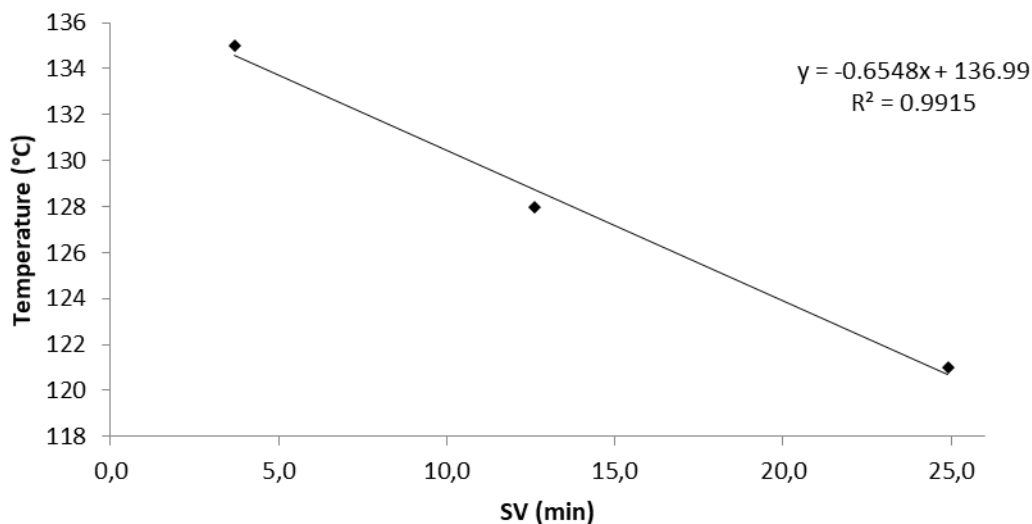


September 15th, 2025**Product code / Código de producto:** IT26-C – BENCO DENTAL (Cod 5726-583)**Product description / Descripción de producto:** Moving front Chemical Integrator for Steam sterilization processes, (type 5 Integrating Indicator according to ISO 11140-1). / Integrador Químico de frente progresivo para procesos de esterilización por Vapor, (Indicador Integrador tipo 5 conforme ISO 11140-1).**Batch number / Número de lote:** B50472**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2025-08-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2030-07-31**Accept condition / Condición de aceptación:** Once the dark bar reaches the ACCEPT zone. / Una vez que la barra oscura llega a la zona ACCEPT.**Process specification / Especificaciones de proceso:** $SV_{121^{\circ}C} = 24.9 \text{ min}$ $SV_{128^{\circ}C} = 12.6 \text{ min}$ $SV_{135^{\circ}C} = 3.7 \text{ min}$ 

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados

son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B50472** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B50472** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO