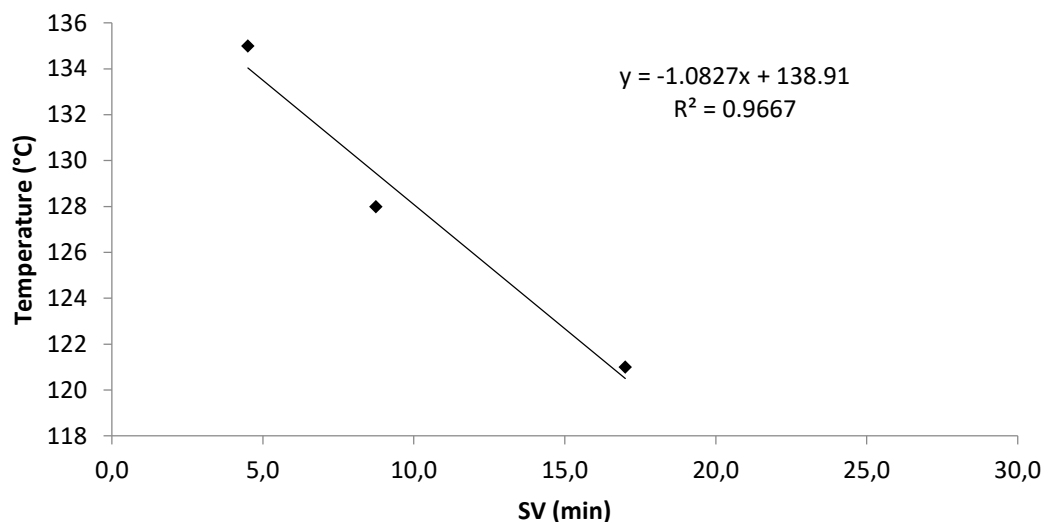


December 13<sup>th</sup>, 2025**Product code / Código de producto:** IT26-1YS

**Product description / Descripción de producto:** Unique point integrator indicator for steam sterilization processes, type 5 (according to ISO 11140-1:2014 standard). / Indicador integrador de un punto para procesos de esterilización por vapor, tipo 5 (conforme a la norma ISO 11140-1:2014).

**Batch number / Número de lote:** B50700**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2025-12-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2030-11-30**Transition color / Color de transición:** Turns to black / Vira a negro.**Process specifications / Especificaciones de proceso:****SV<sub>121°C</sub>** = 17.0 min**SV<sub>128°C</sub>** = 8.7 min**SV<sub>135°C</sub>** = 4.5 min

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con la norma ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **B50700** is in conformity with the specifications established in ISO 11140-1:2014 standard. / El lote de producto **B50700** es conforme a las especificaciones establecidas en la norma ISO 11140-1:2014.

  
**TERRAGENE S.A.**  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO