

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

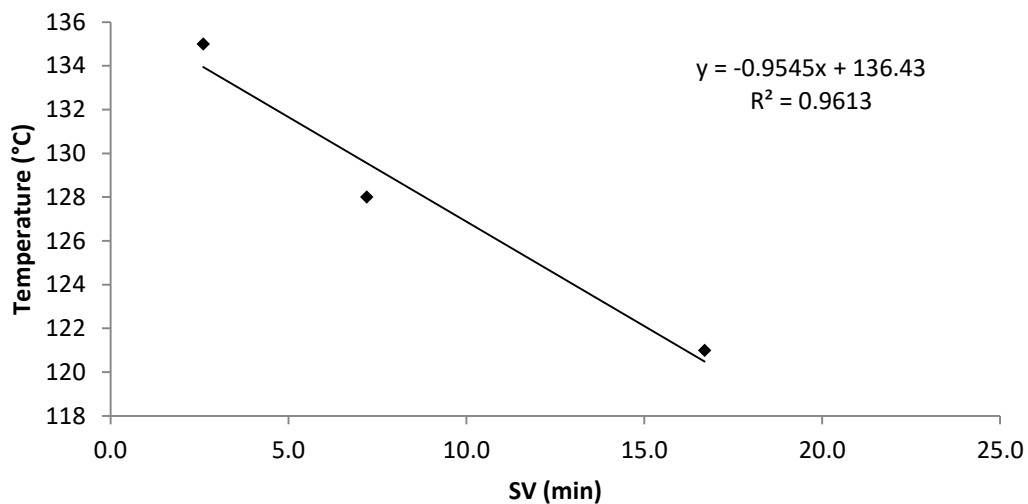
December 14th, 2020Product code / Código de producto: IT26-C

Product description / Descripción de producto: Moving front Chemical Integrator for Steam sterilization processes, (type 5 Integrating Indicator according to ISO 11140-1). / Integrador Químico de frente progresivo para procesos de esterilización por Vapor, (Indicador Integrador tipo 5 conforme ISO 11140-1).

Batch number / Número de lote: IT26C041220Manufacture date / Fecha de fabricación: 2020-12Expiration date / Fecha de vencimiento: 2025-12

Accept condition / Condición de aceptación: Once the dark bar reaches the ACCEPT zone. / Una vez que la barra oscura llega a la zona ACCEPT.

Process specification / Especificaciones de proceso:

SV_{121°C} = 16.7 minSV_{128°C} = 7.2 minSV_{135 °C} = 2.6 min

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **IT26C041220** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **IT26C041220** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO