


November 06<sup>th</sup>, 2024**Product code / Código de producto:** IT26-C**Product description / Descripción de producto:** Moving front Chemical Integrator for Steam sterilization processes, (type 5 Integrating Indicator according to ISO 11140-1). / Integrador Químico de frente progresivo para procesos de esterilización por Vapor, (Indicador Integrador tipo 5 conforme ISO 11140-1).**Batch number / Número de lote:** B40486**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2024-10-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2029-09-30**Accept condition / Condición de aceptación:** Once the dark bar reaches the ACCEPT zone. / Una vez que la barra oscura llega a la zona ACCEPT.**Process specification / Especificaciones de proceso:**SV<sub>121°C</sub> = 24.0 minSV<sub>128°C</sub> = 12.0 minSV<sub>135 °C</sub> = 3.5 min

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados

son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **B40486** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B40486** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.

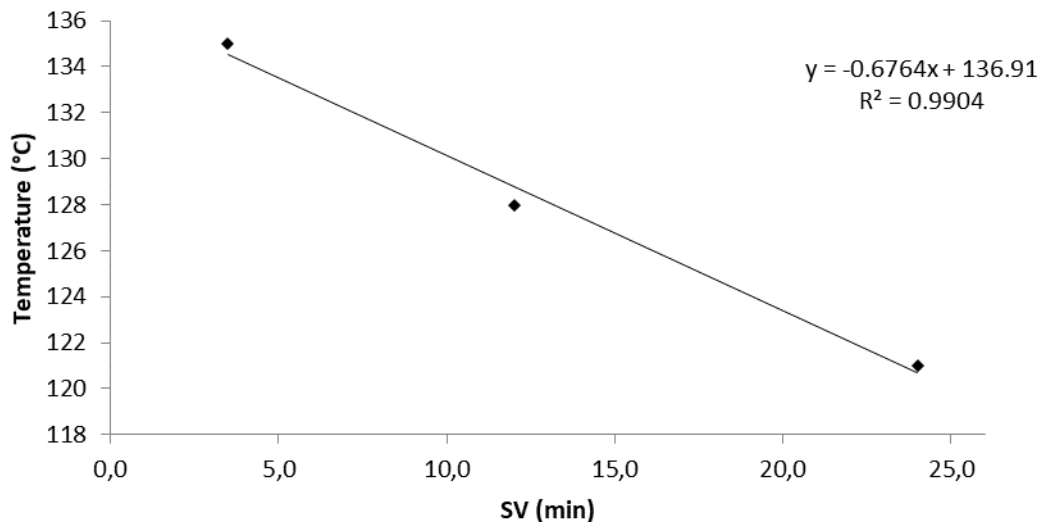

TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO