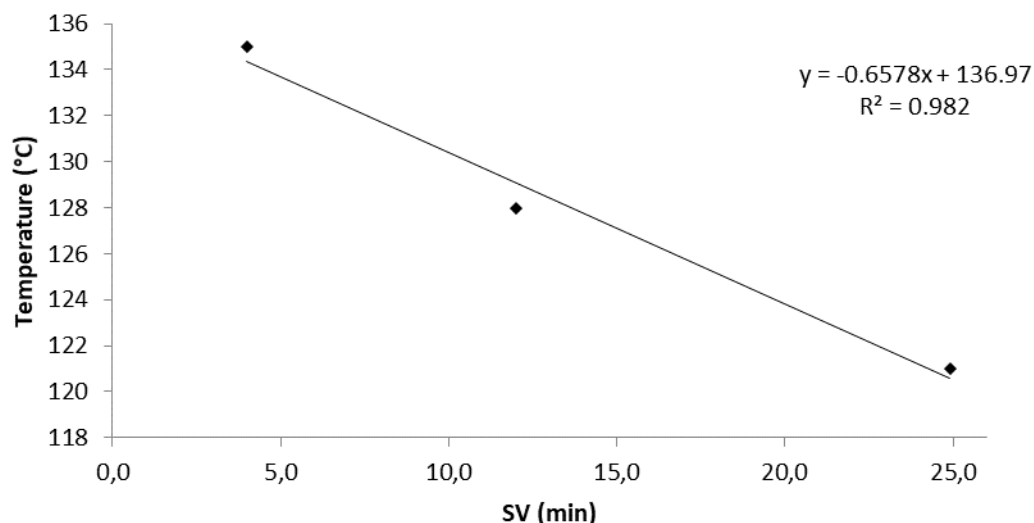


December 16th, 2025**Product code / Código de producto:** IT26-C

Product description / Descripción de producto: Moving front chemical integrator for steam sterilization processes, (type 5 Integrating Indicator according to ISO 11140-1:2014 standard). / Integrador químico de frente progresivo para procesos de esterilización por vapor, (Indicador Integrador tipo 5 conforme a la norma ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: B50690**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2025-11-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2030-10-31

Accept condition / Condición de aceptación: Once the dark bar reaches the ACCEPT zone. / Una vez que la barra oscura llega a la zona ACCEPT.

Process specifications / Especificaciones de proceso: $SV_{121^{\circ}\text{C}} = 24.9 \text{ min}$ $SV_{128^{\circ}\text{C}} = 12.0 \text{ min}$ $SV_{135^{\circ}\text{C}} = 4.0 \text{ min}$ 

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al

momento de la fabricación conforme con la norma ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B50690** is in conformity with the specifications established in ISO 11140-1:2014 standard. / El lote de producto **B50690** es conforme a las especificaciones establecidas en la norma ISO 11140-1:2014.

**TERRAGENE S.A.**Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO