

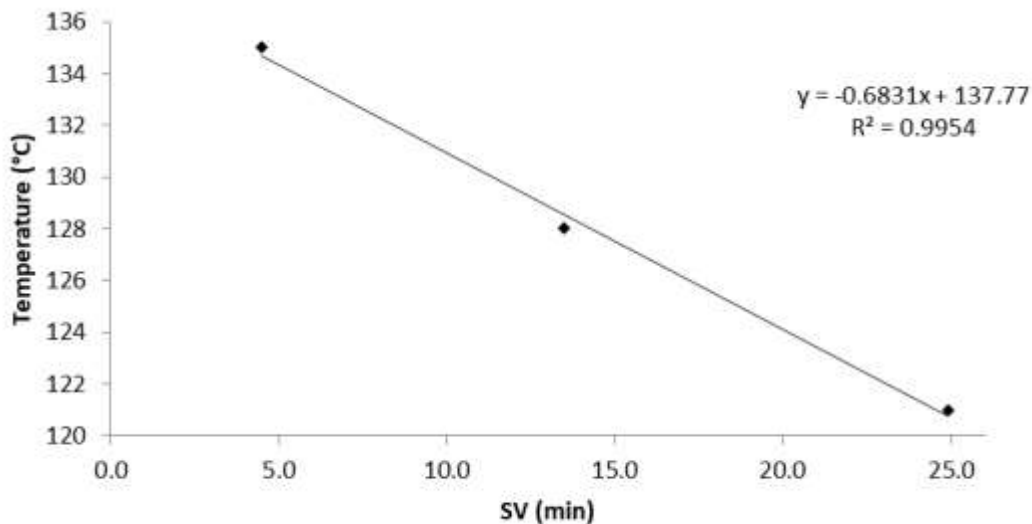
May 27<sup>th</sup>, 2024Product code / Código de producto: IT26-C

Product description / Descripción de producto: Moving front Chemical Integrator for Steam sterilization processes, (type 5 Integrating Indicator according to ISO 11140-1). / Integrador Químico de frente progresivo para procesos de esterilización por Vapor, (Indicador Integrador tipo 5 conforme ISO 11140-1).

Batch number / Número de lote: B40204Manufacture date / Fecha de fabricación: 2024-05-01Expiration date / Fecha de vencimiento: 2029-04-30

Accept condition / Condición de aceptación: Once the dark bar reaches the ACCEPT zone. / Una vez que la barra oscura llega a la zona ACCEPT.

Process specification / Especificaciones de proceso:

SV<sub>121°C</sub> = 24.9 minSV<sub>128°C</sub> = 13.5 minSV<sub>135 °C</sub> = 4.5 min

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados

son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch B40204 meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto B40204 cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.



**TERRAGENE S.A.**  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO