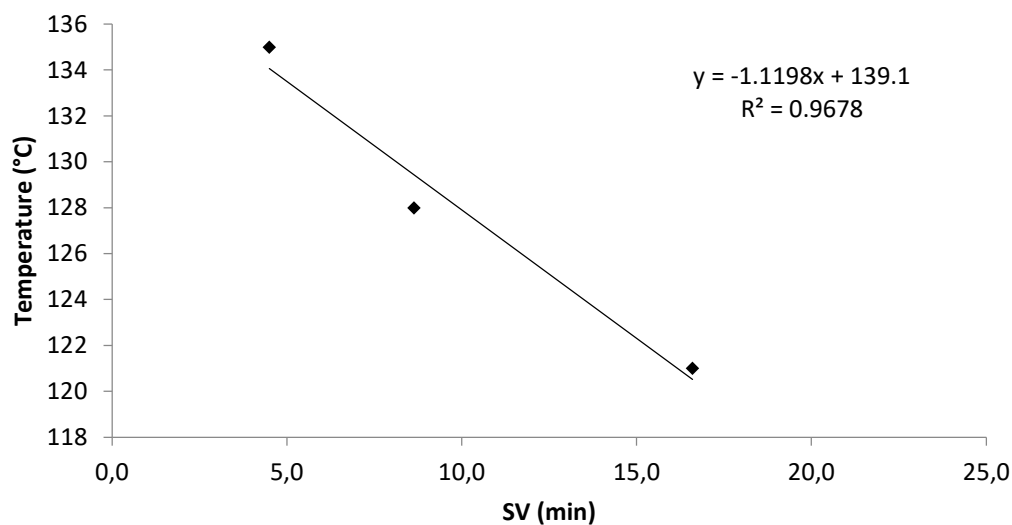


October 29<sup>th</sup>, 2024**Product code / Código de producto:** IT26SAD

**Product description / Descripción de producto:** Unique point Integrator Indicator for Steam sterilization processes in a self-adhesive support. Type 5 according to ISO 11140-1. / Indicador Integrador de un punto para procesos de esterilización por Vapor en soporte autoadhesivo. Tipo 5 conforme ISO 11140-1.

**Batch number / Número de lote:** B40484**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2024-10-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2029-09-30**Transition color / Color de transición:** Turns to green. / Vira a verde.**Process specification / Especificaciones de proceso:**SV<sub>121°C</sub> = 16.6 minSV<sub>128°C</sub> = 8.6 minSV<sub>135°C</sub> = 4.5 min

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **B40484** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B40484** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.

**TERRAGENE S.A.**Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO