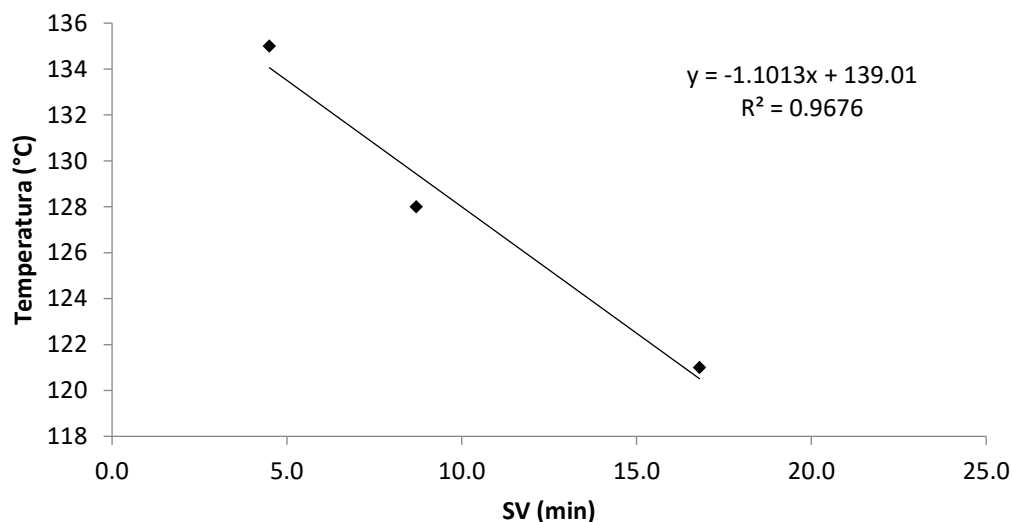


September 23<sup>rd</sup>, 2022**Product code / Código de producto:** IT26SBL**Product description / Descripción de producto:** Unique point Integrator Indicator for Steam sterilization processes. Bilaminated strip, type 5 (according to ISO 11140-1). / Indicador Integrador de un punto para procesos de esterilización por Vapor. Tira bilaminada, tipo 5 (conforme ISO 11140-1).**Batch number / Número de lote:** B20496**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2022-09**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2027-09**Transition color / Color de Transición:** Turns to Green/Vira a Verde.**Process specification / Especificaciones de proceso:**SV<sub>121°C</sub> = 16.8 minSV<sub>128°C</sub> = 8.7 minSV<sub>135°C</sub> = 4.5 min

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **B20496** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B20496** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.

**TERRAGENE S.A.**Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO